Спецификация

TDS/EC диапазон: 0-200 ppm (400 μS)
Максимальная установка: 198 ppm (396 μS)
Установка по умолчанию: 10 ppm
Сигнал: 20 секунд каждые10 минут
Точность: +/- 2%
АТС: да
Коэффициент пересчета: NaCl (примерно 0.5)
Кабель электрода: 72 см
Источник питания: AC 110V / 220V
Кабель питания: 150 см
Размеры: 120 x 80 x 60 мм
Вес (без электрода): 415 грамм

Уход и калибровка

Для ухода за PM-2 нужно совсем немного:

- Не прикасайтесь к электроду. Кожный жир может негативно повлиять на измерение TDS.
- Для очистки электрода используйте спирт и дайте высохнуть на воздухе.
- PM-2 калиброван на заводе раствором150 ppm (NaCl). Перекалибровка не нужна.

Гарантия

Гарантия распространяется на все компоненты изделия и составляет 1 год с даты продажи.

Монитор чистоты воды

TDS/EC монитор

модель PM-2

TDS/EC монитор PM-2 простое устройство используется для мониторинга эффективности очистки воды или системы фильтрации.

Когда уровень чистоты воды достигает максимального предела, PM-2 подаст сигналы красным светом и звуковой тональный сигнал, информируя пользователя о том, что система фильтрации требует обслуживания.

www.hmdigital.com
ISO-9001 сертифицировано

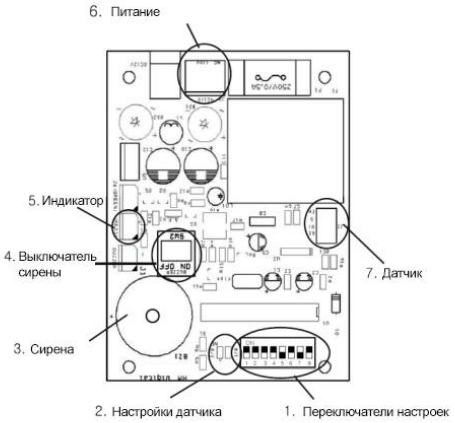

Инструкция

Применение

1. Подключите электрод (см. инсталляция) и кабель питания. Подключите к розетки и питание включится автоматически.
2. При достижении уровня TDS установленного предела, включится световая и звуковая сигнализация (20 секнд каждые 10 минут) пока уровень TDS не снизится ниже установелнного уровня.

Настройка

PM-2 по умолчанию настроен на 10 ppm. Для изменения:

1. Откройте крышку блока, открутив четыре винта.
2. Снимите светодиод с крышки (возможно потребуется его подтолкнуть).
3. Отрегулируйте микропереключатели в нужное положение (см. диаграмму ниже).
4. Установите светодиод и крышку блока обратно.

Обратитесь к производителю системы очистки воды для рекомендуемых настроек.

Дистрибьютор в России и СНГ:
ИП Годованюк И.В.

115304 г. Москва, БЦ Каспийский, ул. Каспийская д.22, к.1, стр.5
тел. +7 495 150-16-00, 8 800 500-50-20
www.ecounit.ru

Инсталляция

Для установки электрода в систему фильтрации воды:

1. Вставьте белый электрод в Т-фитинг.
2. Установите контакты датчика таким образом, чтобы они были перпендикулярны направлению Т. (Вы должны быть в состоянии видеть контакты, если вы смотрите через фитинг. Смотрите иллюстрацию ниже).
3. Выключите источник воды.
4. Разрежьте трубку подачи фильтрованной воды между филтиом и дозатором.
5. Вставьте два отрезка трубки в Т-фитинг.
6. Включите источник воды.



Закрепление PM-2:
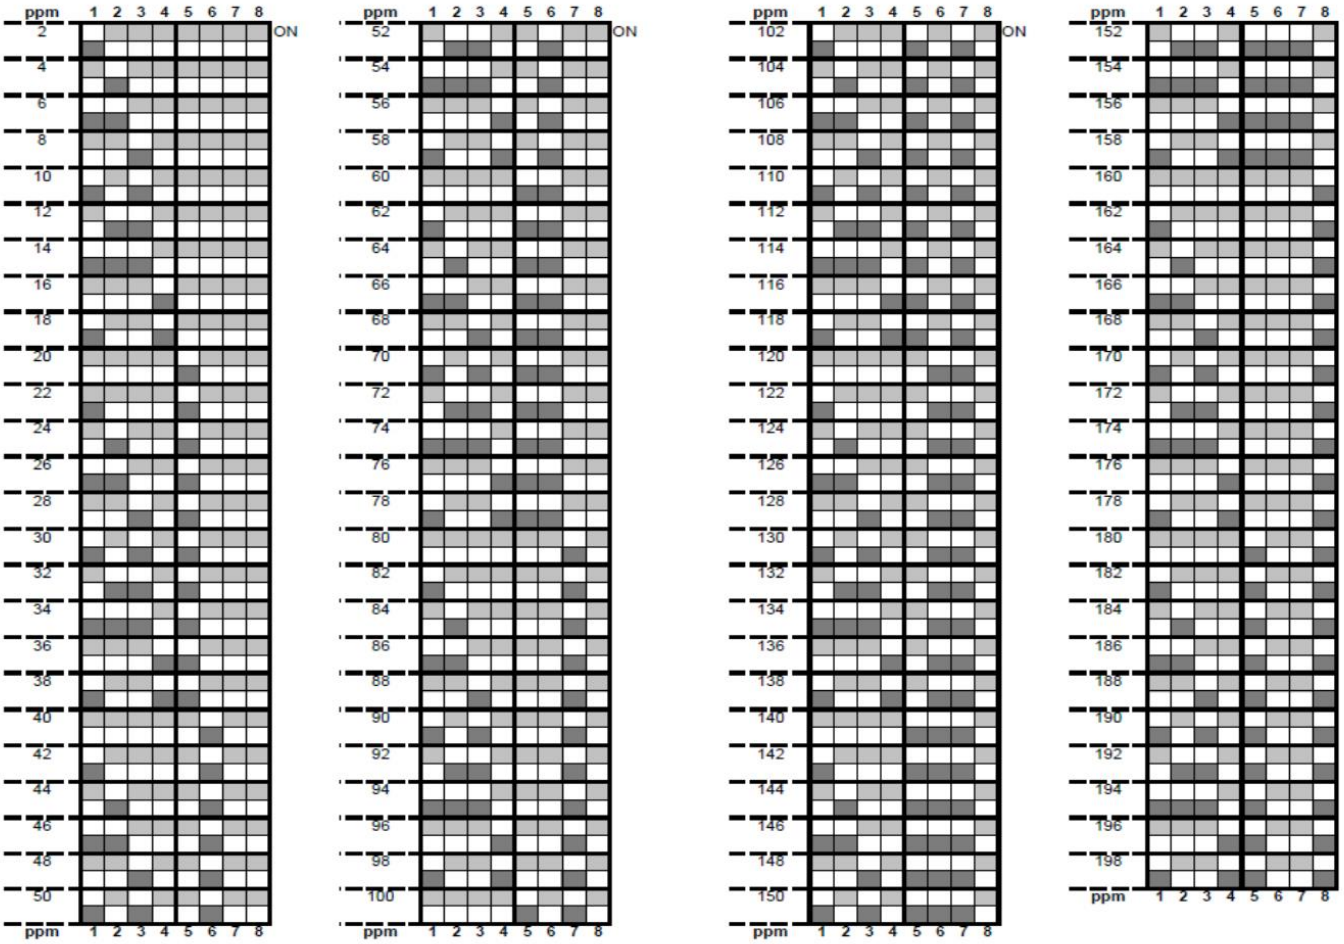
1. PM-2 может быть установлен на двухсторонний скотч.
2. Установите PM-2 вблизи системы фильтрации воды, так что кабель датчика и кабель питания доставал.